

Relatório de dosimetria de ruído

Data da avaliação: 05/06/2023

Dados da Avaliada

Empresa: UVG - Canoinhas

Endereço:

Dados do Avaliado(a)

Avaliado(a): Patricia Oliskowski

Departamento: Cursos Técnicos

Função: Professora

Dados do Avaliador(a)

Empresa: SEGURANÇA

Avaliador(a): Caroline Almeida

Resumo da dosimetria com audiodosímetro CHROMPACK SmartdB nº de série: 0000000778

Dosímetros	Nível de Critério	Nível Limiar	Taxa de dobra	Ponderação em Frequência	Ponderação Temporal
Dosímetro 02	85 dB	80 dB	5 dB	A	Slow

Data da Medição: 05/06/2023

Jornada de trabalho: 08:48

Calibração de campo @1kHz:

Inicial: 94,0 dB @ 02/06/2023 / 08:49:50

Final: Sem, dB @ 05/06/2023 / 21:26:46

Desvio:

Calibração do audiodosímetro: Data: 12/01/2021

Nº cert:

Tempo de amostragem: 01:38:00

Tempo em pausa: 00:00:00

Eventos:

Início: 19:49:21

Final: 21:26:34

Resultados Dosímetro 02


LAVG: 69,7 dB(A) DOSEp: 13,2 %

NEN: 70,4 dB(A)


DOSE: 2,4 %

DOSE 8h: 12,0 %

Nível equivalente por banda de oitava - LEQ - dB

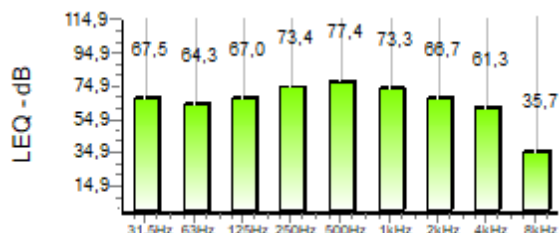

Nível equivalente por banda de oitava ponderado - LEQ - dB(A)

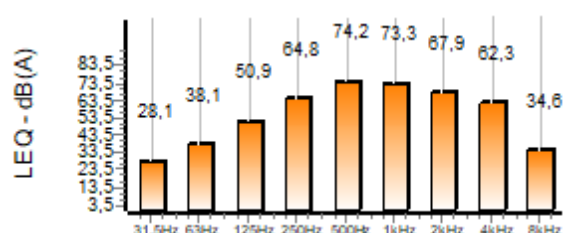

Registro de Campo:

Comentários:

Histograma Gráfico

Data da dosimetria: 05/06/2023

Tempo amostrado: 01:38:00 Hora de início: 19:49:21 Modelo: SmartdB

Tempo em pausa: 00:00:00 Hora de Término: 21:26:34 N° de Série: 0000000778

